

平成 26 年 2 月 4 日

お客様各位

株式会社 瑞光メディカル
品質保証部 品質保証責任者
江村 収
TEL：072-653-8877

「プラスモイストTOP-P」離型紙色目変更のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて作業効率向上の為、「プラスモイストTOP」にて平成24年10月より先行して実施しております離型紙色目変更の件ですが、「プラスモイストTOP-P」におきましても実施させて頂きたく存じます。下記をご確認いただき、何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

敬具


記

変更箇所	商品名「プラスモイストTOP-P」の離型紙色目変更 (添付の写真をご参照下さい)
変更予定時期	2014年2月出荷分、ロット No. 401285201 より変更

変更箇所は離型紙の色目のみで、製品品質、使用方法に関しては一切変更ございません。

以上、何か不明点等ございましたら、弊社品質保証部までご連絡ください。
何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

現行品（変更前）

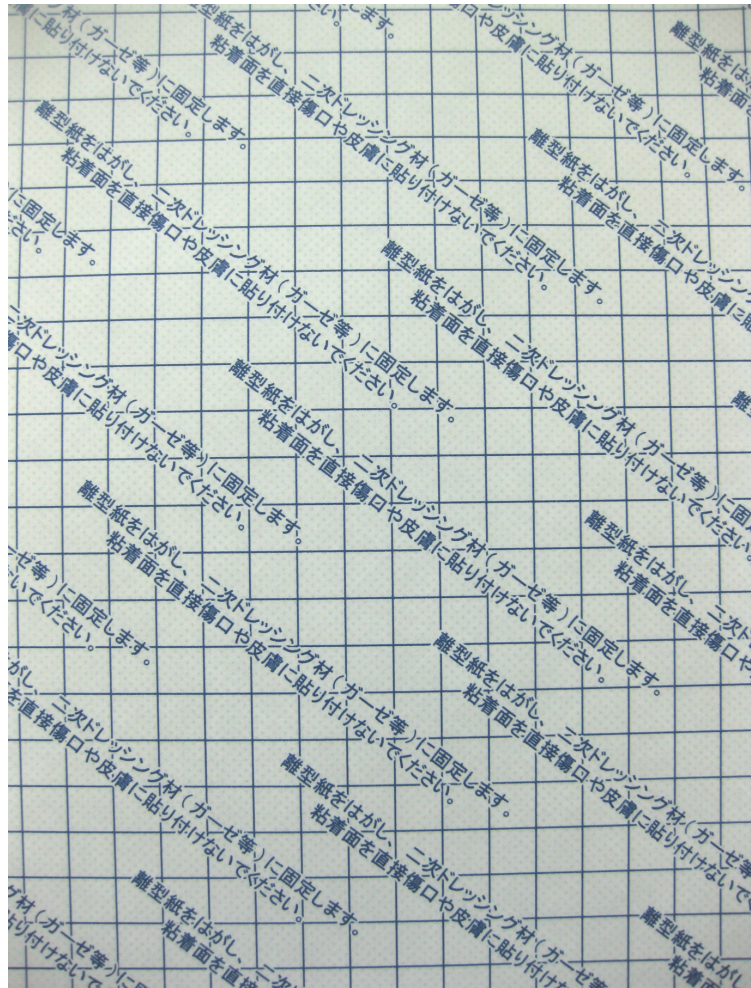

変更後

